



Alexis[®] O


C-セクションプロテクター/リトラクター（帝王切開用）



Alexis O

C-セクション プロテクター/リトラクター (帝王切開用)

クリニカルエビデンスにより、Alexis O C-セクション プロテクター/リトラクター (帝王切開用) を使用した際の患者の満足度と予後が改善されたことが示されています。¹

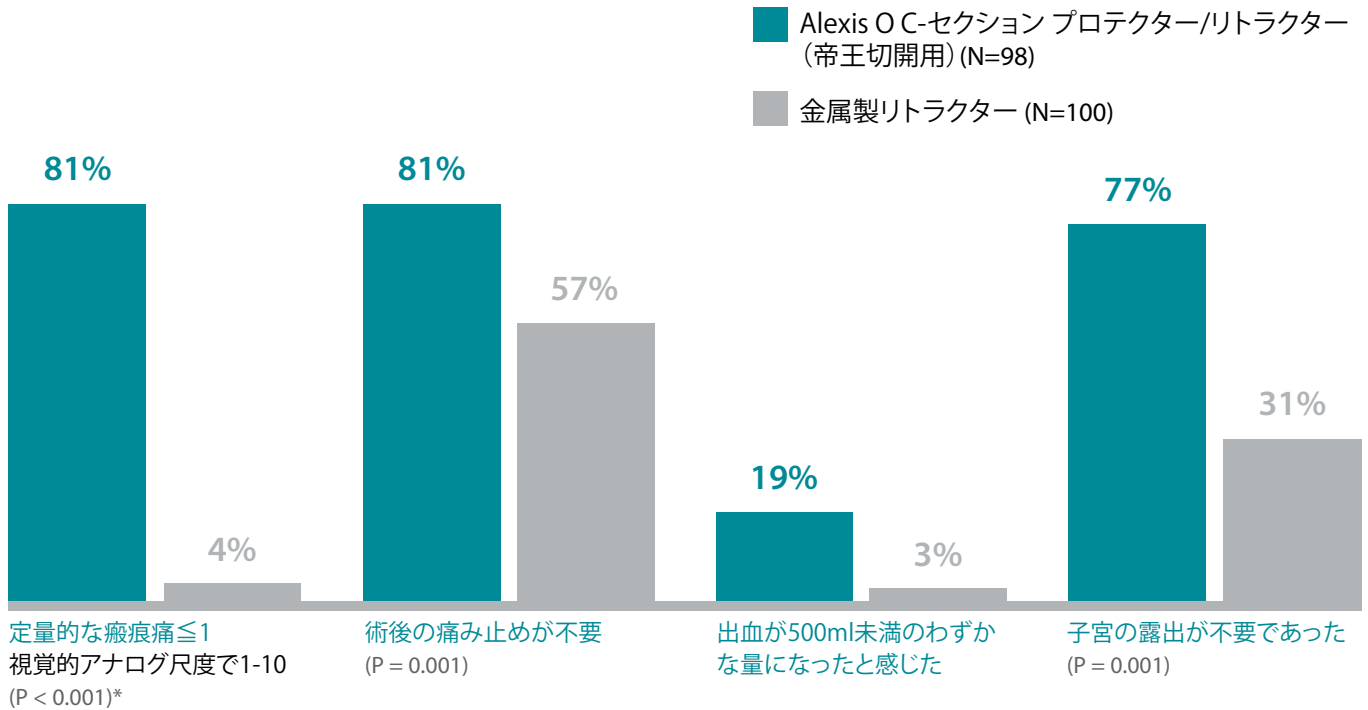

1% 手術部位感染

VS. 8% 手術部位感染**

* 2標本T検定を行った2グループ間に、有意差が算出された。

** 術後6-8週間の調査 ($P=0.035$)

使用上のメリット

小さな切開で大きく開創します。

術中に手をフリーにすることができます。

傷口の疼痛、出血および術後の鎮痛剤を減少させることができます。¹

ローリスクの帝王切開手術における創感染を抑制します。¹

術中の視野を改善します。¹

体内での子宮縫合を可能にし、²術中の吐き気を抑えます。¹

傷口の治癒について患者の満足度が向上します。¹

膀胱リトラクターの必要性を減らすことができます。

術野から皮下脂肪を圧排できます。



Alexis O C-セクションプロテクター/リトラクター (帝王切開用)

製品番号	サイズ	シース長(cm)	対応切開長(cm)	販売単位
G6313	L	21	9-14	5個/箱
G6314	XL	31	11-17	5個/箱

1. Hinkson L, Siedentopf J-P, Weichert A, Henrich W. Surgical site infection in cesarean sections with the use of a plastic sheath wound retractor compared to the traditional self-retaining metal retractor. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol.* 2016;203:232-238. (Level of Evidence 1)
2. Siddiqui M, Goldszmidt E, Fallah S, Kingdom J, Windrim R, Carvalho JC. Complications of exteriorized compared with in situ uterine repair at cesarean delivery under spinal anesthesia: A randomized controlled trial. *Obstet Gynecol.* 2007;110(3):570-575. (Level of Evidence 1)

販売名: Alexis・ウインドプロテクター/リトラクター
医療機器製造販売認証番号: 302ACBZX00028000

★単回使用
★添付文書を必ずお読みになってからご使用ください

© 2022 Applied Medical Resources Corporation. All rights reserved.

Applied Medical, Appliedメディカルのロゴおよび®のついた名称はApplied Medical Resources Corporationの登録商標で、次の国で登録されています。
オーストラリア、カナダ、日本、韓国、米国、英国、EU加盟国。

■製造販売元

Applied Medical Japan株式会社
〒101-0047 東京都千代田区内神田1-14-8
KANDA SQUARE GATE 6階
www.appliedmedical.co.jp

■製造業者

アプライドメディカル リソーサズ社 アメリカ合衆国
www.appliedmedical.com

